


止まれ

再確認

磁性体(金属など) 持っていませんか？

MR磁性体吸着事故が
起きています

入室の前にもう一度 **チェック！！**

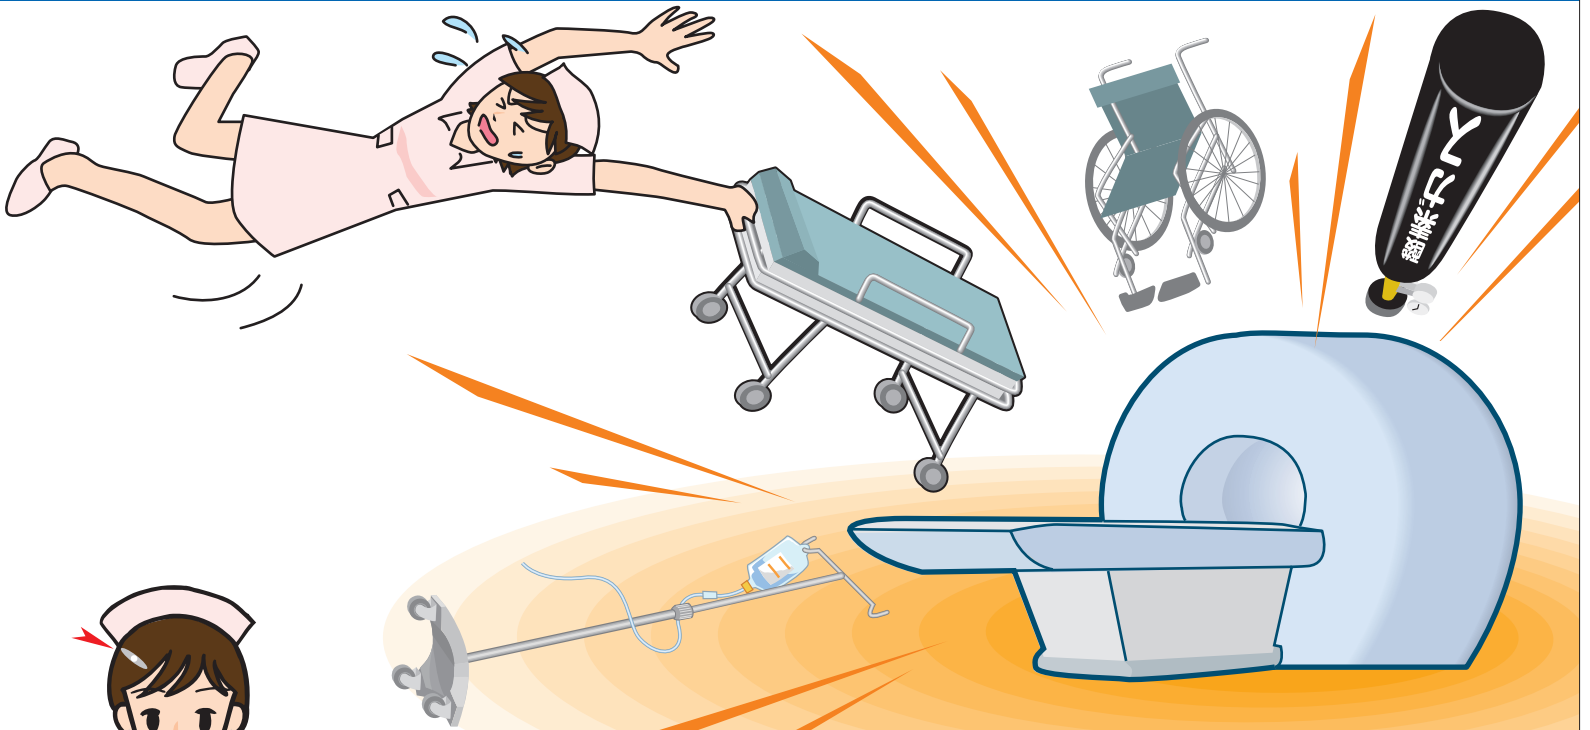

ポケットの中もチェック!!



事務用品



装身具



ストレッチャー



酸素ボンベ



点滴台



車椅子

大きなモノから小さなモノまで、

磁性体(金属類など)のMR検査室内への持ち込みは厳禁です。

慣れていても、入室の前には再度確認を！
















- MR検査室内への患者搬入時や他の用件での入室時に、点滴台、ストレッチャー、酸素ボンベ等の大きなものから、ポケットに入れた事務用品・装身具等の小さなものまでMR装置に吸着される事故が発生しています。知らずに持ち込んだり、知識はあってもうっかりとして持ち込むケースがありますが、重篤な事故につながる場合があります。
- MR装置の電源が入ってなくても、室内には吸着事故につながる強力な磁場があります。

JIRA

<http://www.jira-net.or.jp/>

MR室入室前のチェックリスト

金属製または磁気に敏感な物品、素材がわからないものを持っていませんか？
これらを持ったまま、MR室へ入室すると事故発生につながり大変危険です。

- | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|---|--------------------|
| <input type="checkbox"/> |  | 聴診器 | <input type="checkbox"/> |  | ペン、鉛筆 |
| <input type="checkbox"/> |  | 安全ピン | <input type="checkbox"/> |  | かぎ |
| <input type="checkbox"/> |  | 金属フレームの
めがね | <input type="checkbox"/> |  | ポケットナイフ、
はさみ |
| <input type="checkbox"/> |  | 時計 | <input type="checkbox"/> |  | 医療用鋼鉄小物
(メスなど) |
| <input type="checkbox"/> |  | 装身具、
アクセサリ | <input type="checkbox"/> |  | ヘアピン、
バレッタ(髪止め) |
| <input type="checkbox"/> |  | 財布または
紙幣クリップ | <input type="checkbox"/> |  | 補聴器 |
| <input type="checkbox"/> |  | 小銭 | <input type="checkbox"/> |  | その他素材の
わからないもの |
| <input type="checkbox"/> |  | 磁気カード
(IDカード、銀行カード
クレジットカードなど) | | | |