




もう一度確認しよう!

磁性体(金属など)身につけていませんか?


MR磁性体吸着事故が起きています

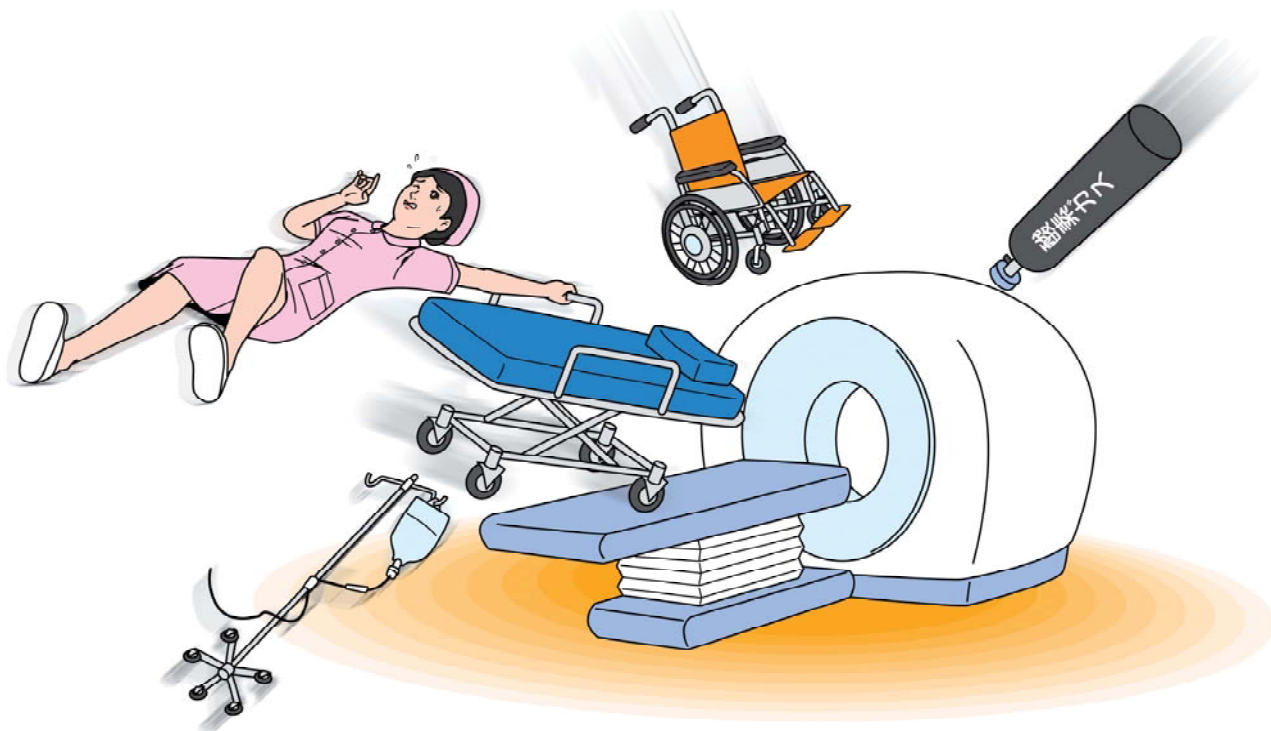

大きなモノから小さなモノまで、
磁性体(金属類など)のMR検査室内への
持ち込みは厳禁です。

慣れていても、入室の前には再度確認を!

- MR検査室内への患者搬入時や他の用件での入室時に、点滴台、ストレッチャー、酸素ボンベ等の大きなものから、ポケットに入れた事務用品・装身具等の小さなものまでMR装置に吸着される事故が発生しています。知らずに持ち込んだり、知識はあってもうっかりとして持ち込むケースがありますが、重篤な事故につながる場合があります。
- MR装置の電源が入ってなくても、室内には強力な磁場があります。



事務用品



装身具



ストレッチャー



酸素ボンベ



点滴台



車椅子

JIRA

<http://www.jira-net.or.jp/>