


年表→ 1978年 1月 アロカ Ohio-Nuclear社製全身用CTデルタスキャン2000シリーズを販売→下記資料をリンクする

1978年 1月

アロカ Ohio-Nuclear社製全身用CTデルタスキャン2000シリーズを販売

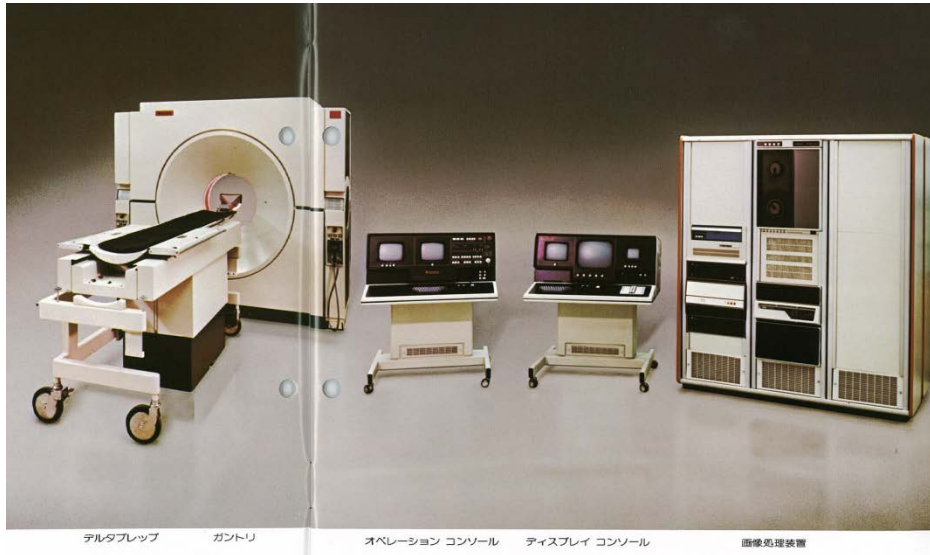

#### 主な仕様

スキャン方式: 第4世代  
対象部位: 全身  
有効視野: 20/40/50cm $\Phi$   
スキャン時間: 2/4/8秒  
検出器: 720素子、固定検出器  
スライス厚: 4/7/10mm  
ガントリ傾斜:  $\pm 20^\circ$   
画像マトリックス: 256/512マトリックス

デルタスキャン2000シリーズ(カタログより)