


医用放射線機器安全管理センター MRC情報

Vol. **21**
No.2
2012年8月
通巻43号

MEDICAL RADIATION FACILITIES SAFETY ADMINISTRATION CENTER

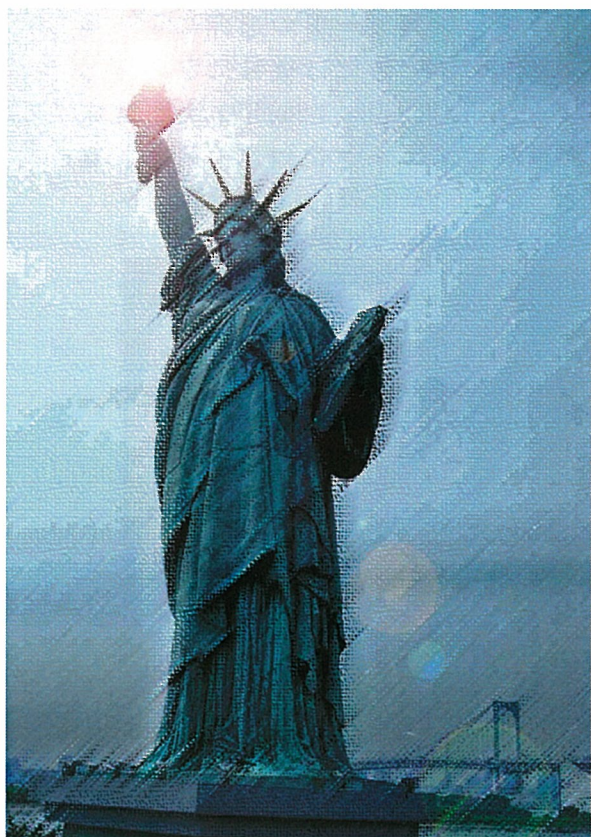

目次

1. 「Optima CT660」が採用した腹部領域における
基礎技術スピードと画質を両立するCViR ①
2. 次世代検出器Stellar Detectorが実現する
低被ばくCT検査 ④
3. 逐次近似法を用いたCT用
ノイズ低減処理 Intelli IP™ ⑦
4. JIRA 安全管理情報と保守点検情報のご紹介 ⑪
(放射線関連装置の始業・終業点検表のご紹介)
5. おしらせ ⑭
 - ① 第29回 MRC 認定講習会開催
 - ② 第25回 更新登録講習開催
6. 編集後記 ⑮
7. 表紙画像「輝くトーチ」製作の説明 ⑮

メールアドレス登録と登録済内容の変更手続きのお願い

MRCでは皆様との連絡をより迅速・正確に行うために電子メールによる連絡方式を導入しています。未登録の方および転勤・転職等で登録済情報の変更の有る方はJIRA MRC ホームページ*より手続きをして下さい。変更されないと講習案内等が送付されません。

*JIRA MRC ホームページ <http://www.jira-net.or.jp/commission/mrc/index.html>

お問合せ先

日本画像医療システム工業会 医用放射線機器安全管理センター
TEL 03-3816-3450 FAX 03-3818-8920