




日本市場におけるメーカー別主要機種(1)

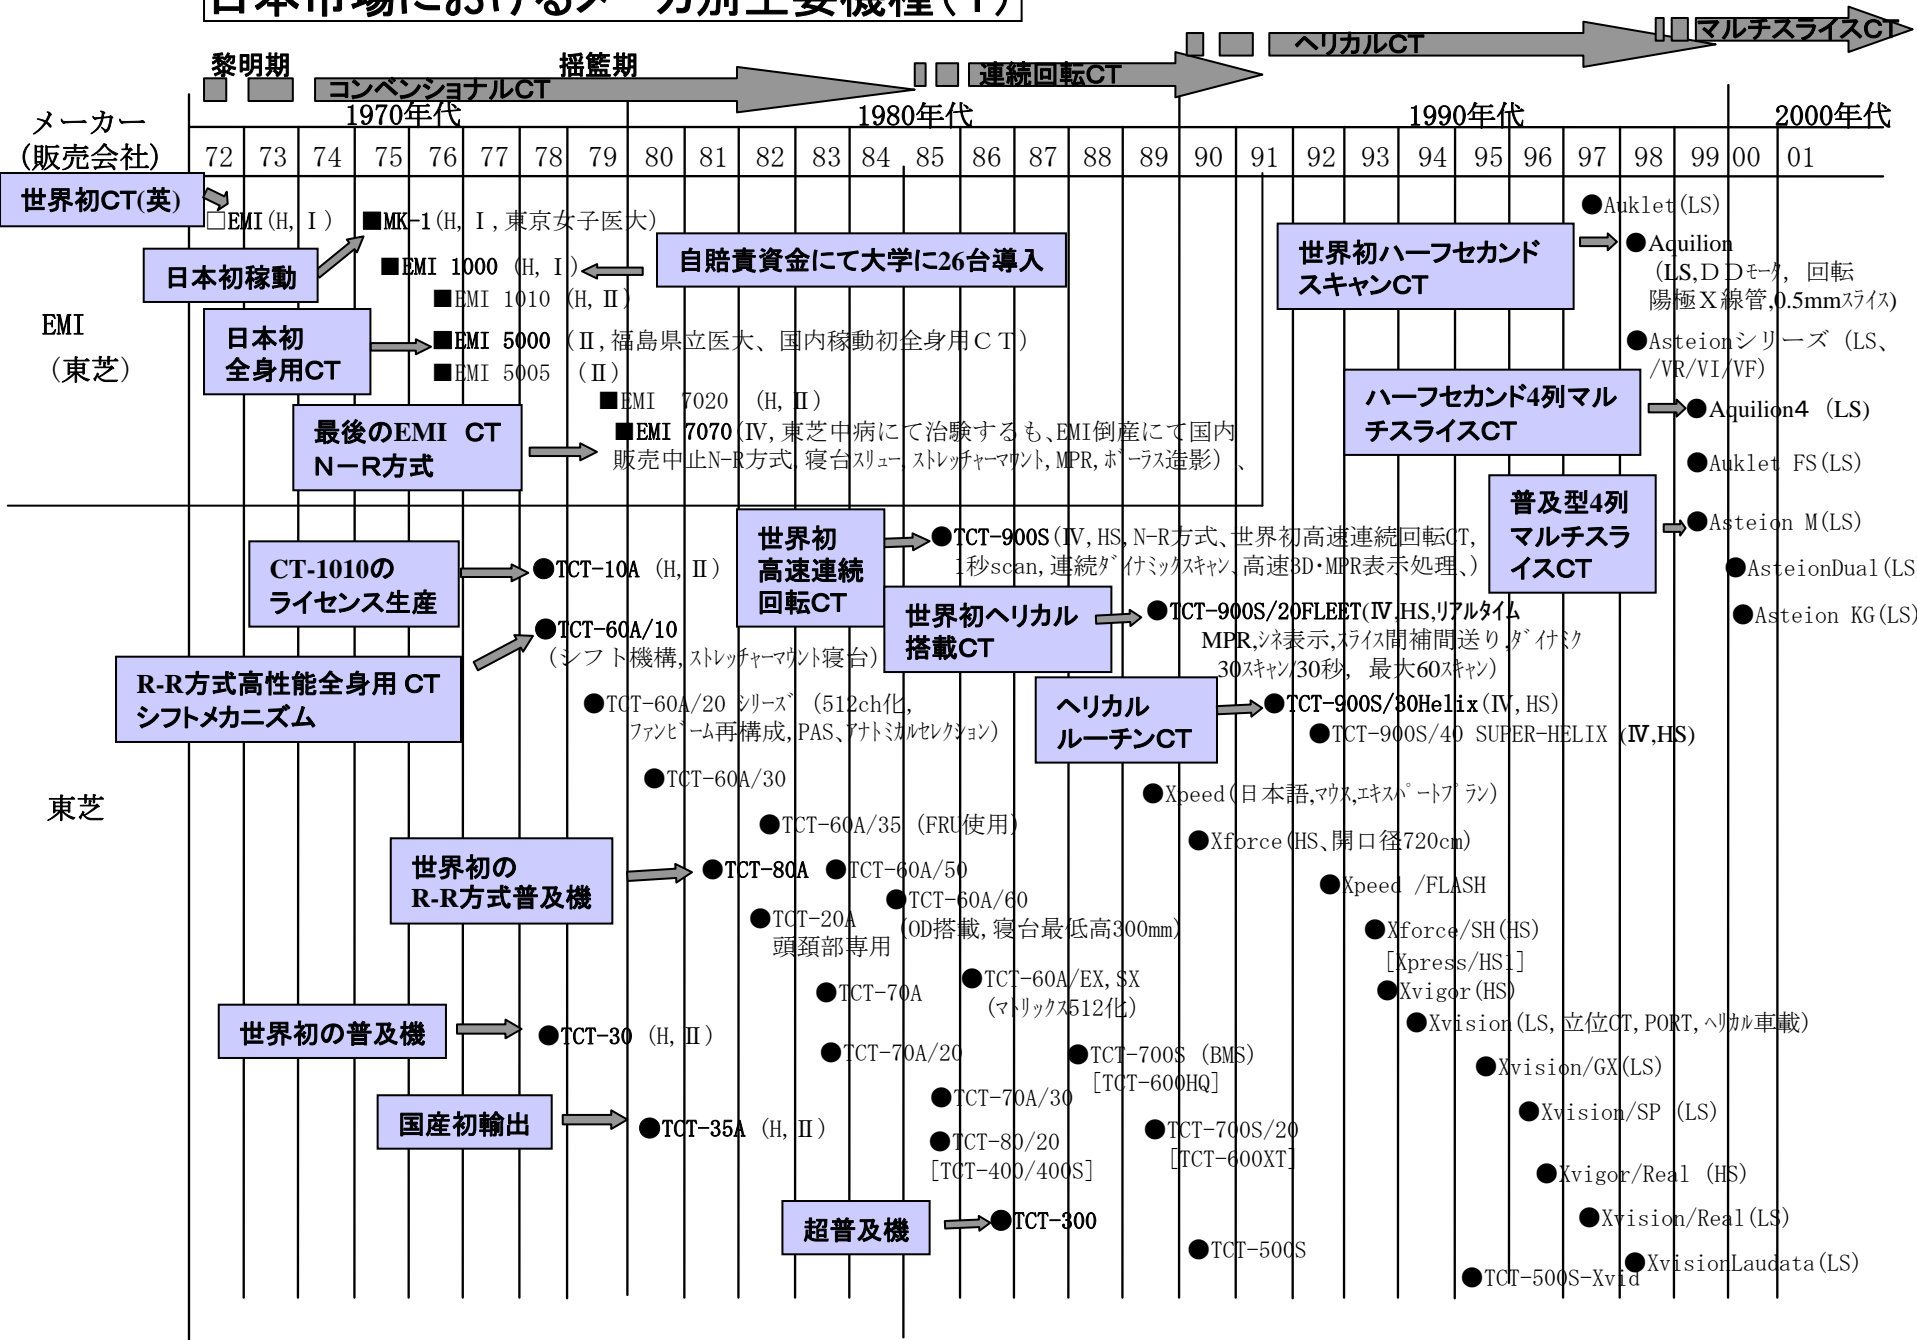


日本市場におけるメーカー別主要機種(2)

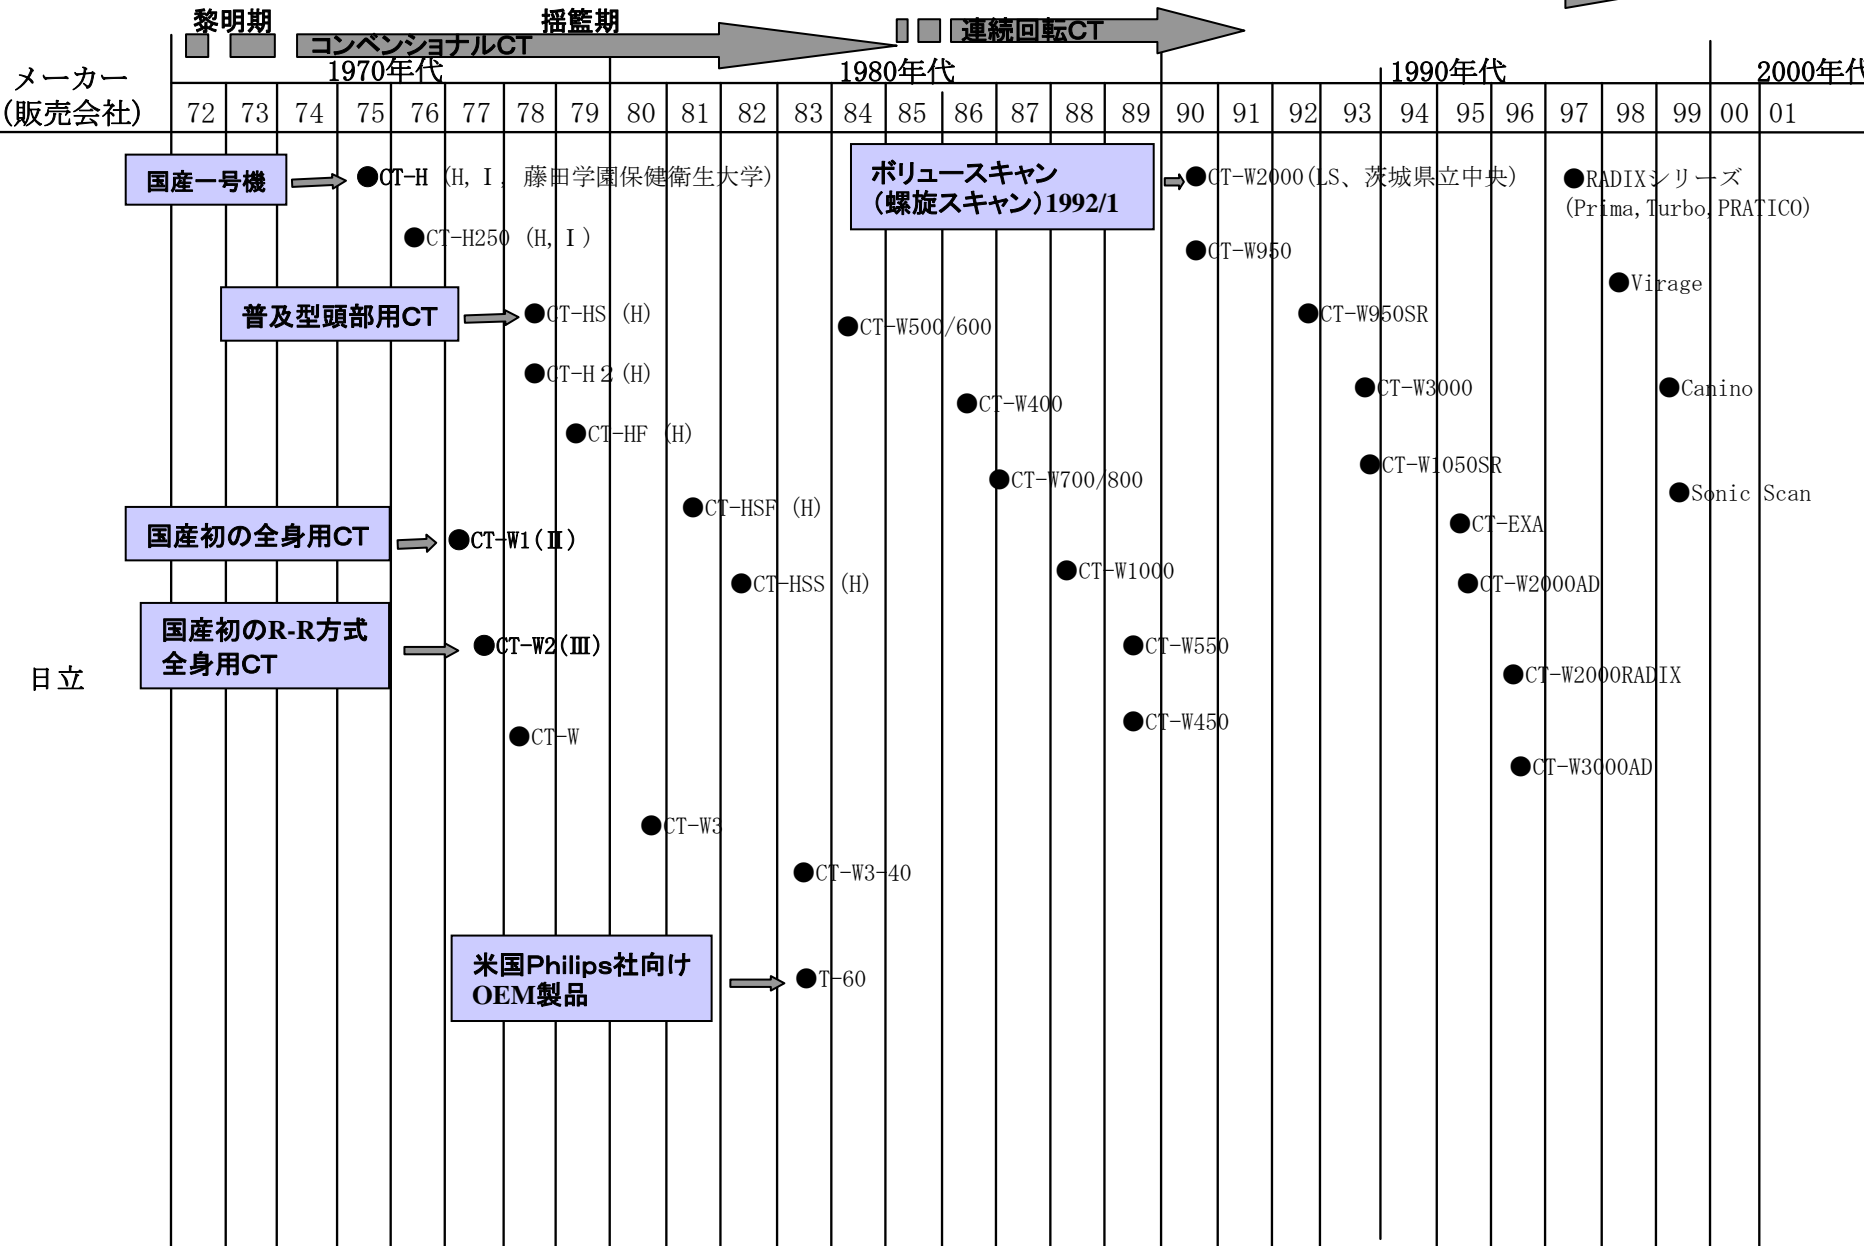

日本市場におけるメーカー別主要機種(3)

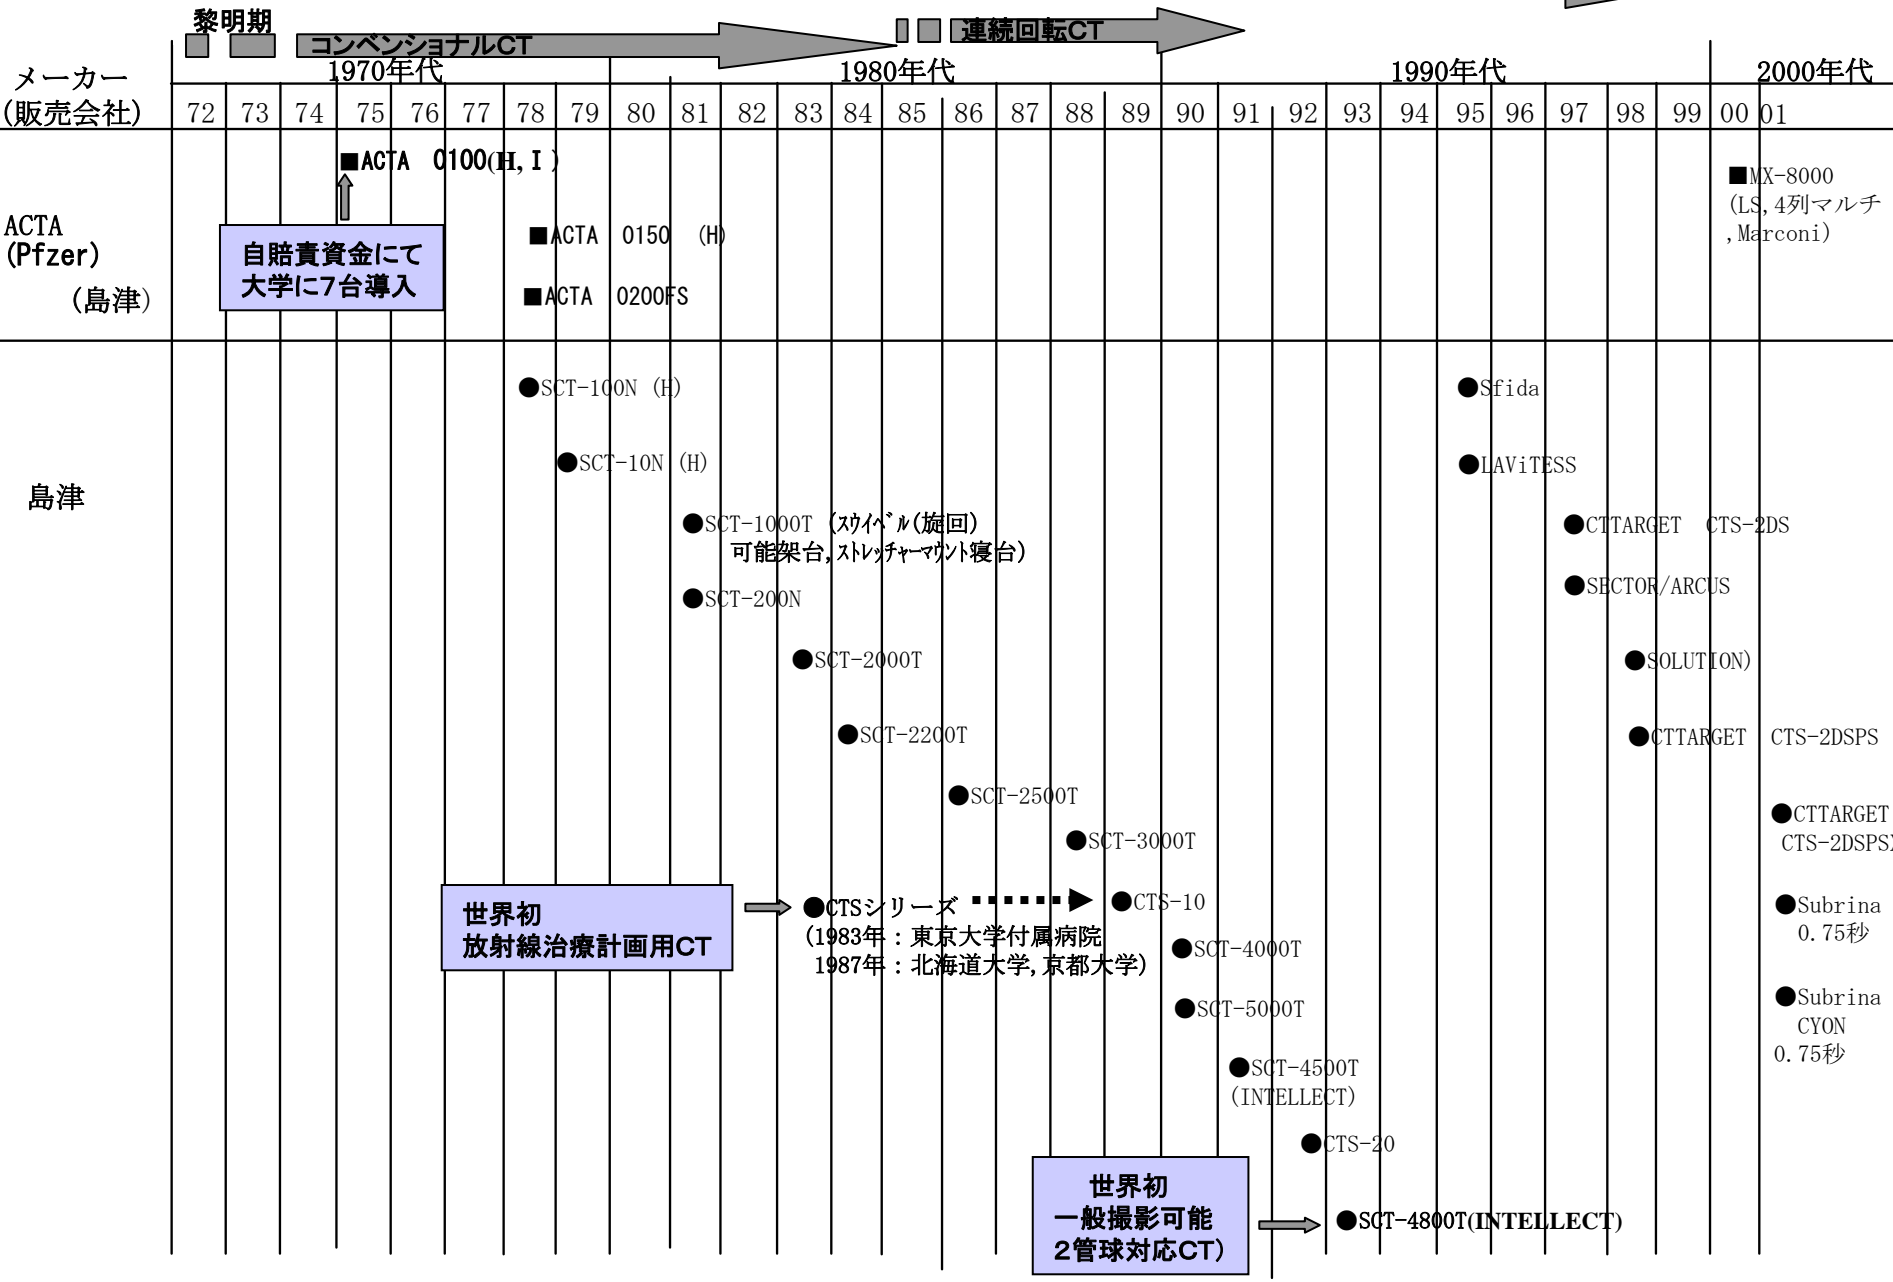


日本市場におけるメーカー別主要機種(4)

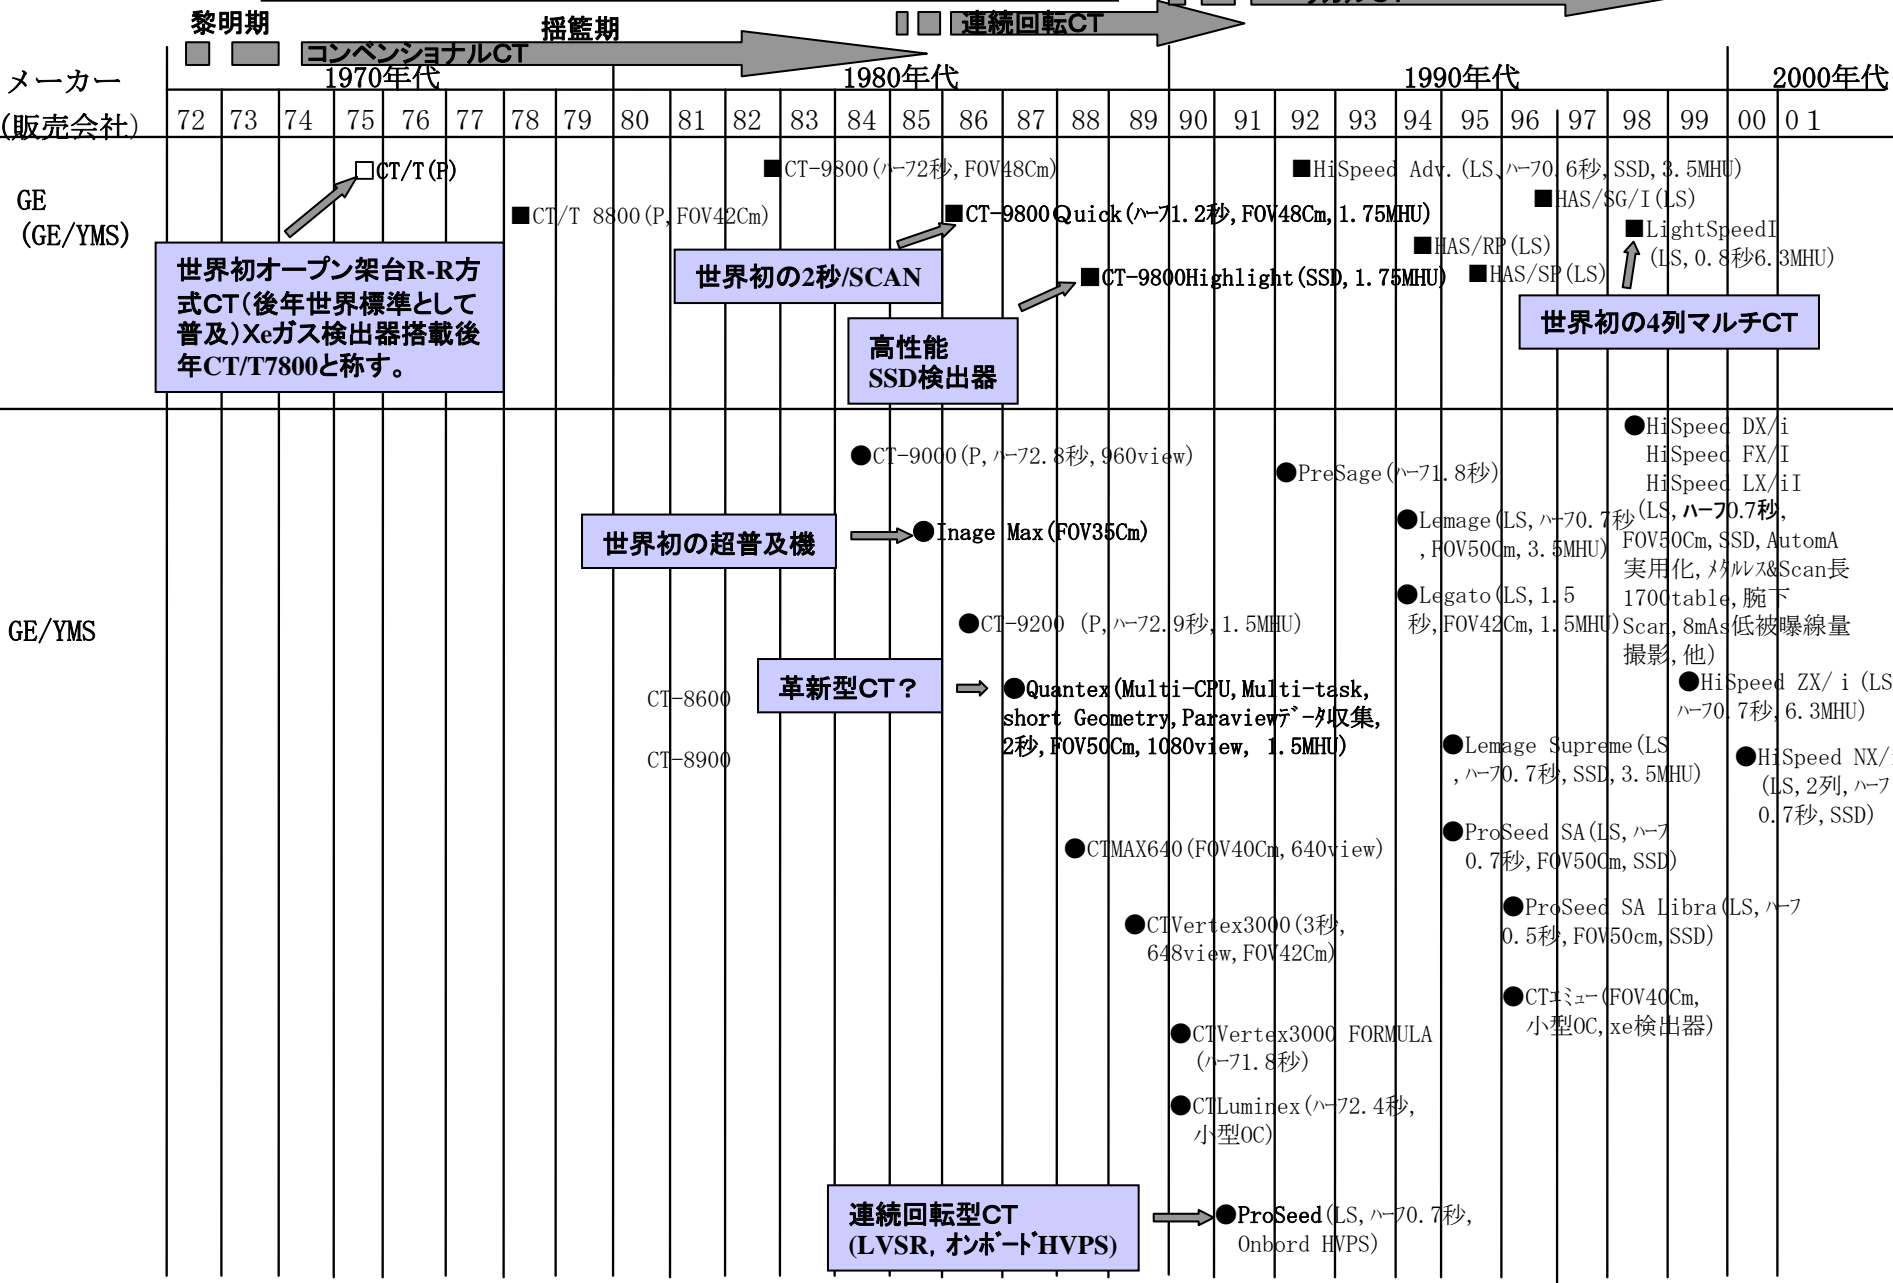

日本市場におけるメーカー別主要機種(6)

訂正:20090413 平尾

■■マルチスライスCT

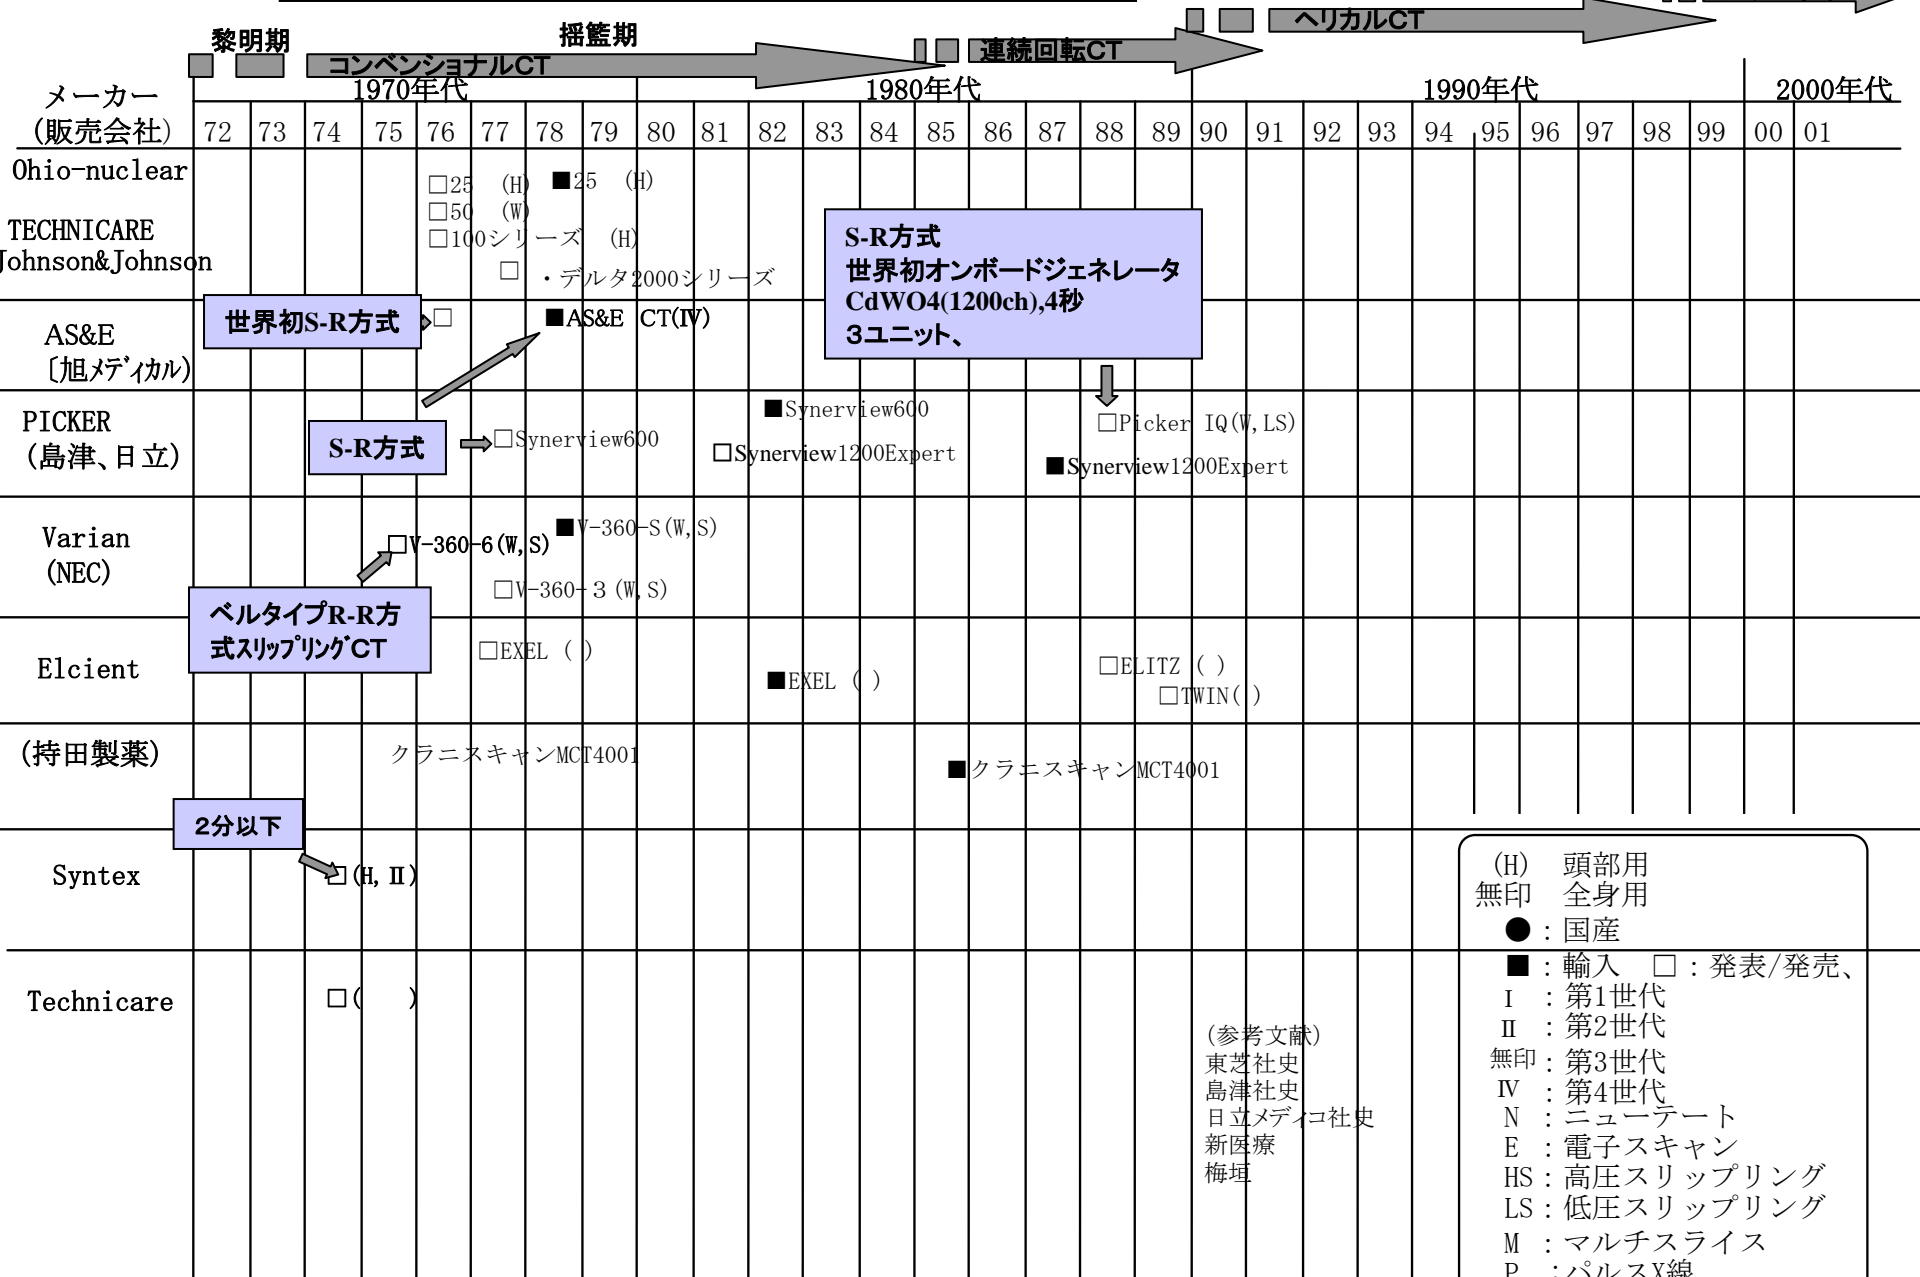

S-R方式
世界初オンボードジェネレータ
CdWO4(1200ch),4秒
3ユニット、

世界初S-R方式

S-R方式

ベルトタイプR-R方式
スリッピングCT

2分以下

(H) 頭部用
無印 全身用
● : 国産
■ : 輸入 □ : 発表/発売、
I : 第1世代
II : 第2世代
無印 : 第3世代
IV : 第4世代
N : ニューテート
E : 電子スキャン
HS : 高圧スリッピング
LS : 低圧スリッピング
M : マルチスライス
P : パルスX線

(参考文献)
東芝社史
島津社史
日立メディコ社史
新医療
梅垣